

実験系廃棄物

瓶



きれいに洗浄された薬品瓶のみ
生活系ごみの「瓶」と同じかごへ
洗浄されていない瓶は「有害付着物」へ
小瓶は「不燃ごみ」へ

有害付着物



有害物が付着している物は
蓋付きドラム缶に入れる
無害な乾燥剤や吸着剤は
容器に入れ 物質名を表示する

不燃ごみ




ガラス器具、石膏等
アルミ箔は十分に圧縮する
生活系と同じドラム缶へ

実験系可燃ごみ



再利用できる物は 洗浄して使い、
温室効果ガスの排出量削減に努める

疑似医療系

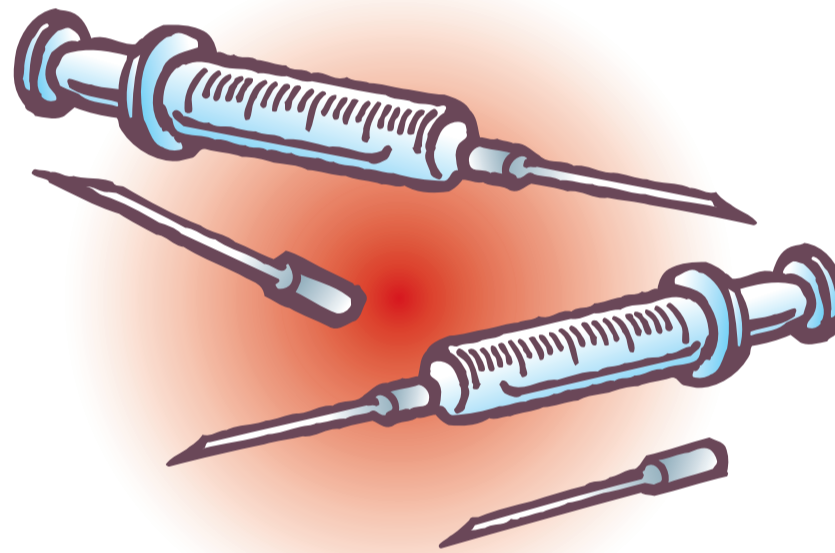

鋭利な物は ポリ容器に入れる
プラスチックは 透明袋でも良い
6月・12月に集荷します

廃薬品等




不用薬品や有害固形物・汚泥等
11月に集荷します

無機系廃液

| | | |
|-------|---|----------------------|
| テープの色 | 赤 | A-a … 無機水銀廃液 |
| | 青 | B … シアン・ヒ素廃液、pH>10.5 |
| | 茶 | C … フッ素廃液 |
| | 黄 | D-a … 一般重金属廃液 |
| | 黄 | D-b … 有機物含有重金属廃液 |
| | 黒 | E … 写真定着廃液 |

劣化したポリ容器は、使用しないこと

上と側面に所属等を記入する



無機系及び有機系廃液の処理依頼方法は、
特殊廃液処理施設(TEL 642-2217)の「利用の手引き」を参照

有機系廃液

H-a … ハロゲン化有機溶剤
H-b … その他の有機廃液
(油類や水系も含む)
水系は、必ず pH>5 とする

